


# FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE Merapur® 1200 UI

Antes de iniciar la administración de **Merapur® 1200 UI** compruebe que dispone de todos los componentes necesarios.

## ¿Qué necesita?

El envase de **Merapur® 1200 UI** incluye:

- A) 1 vial de **Merapur®**
- B) 2 jeringas precargadas con el disolvente para reconstitución.
- C) 1 aguja para reconstitución.
- D) 18 toallitas con alcohol.
- E) 18 jeringas desechables con aguja prefijada para la administración\*.

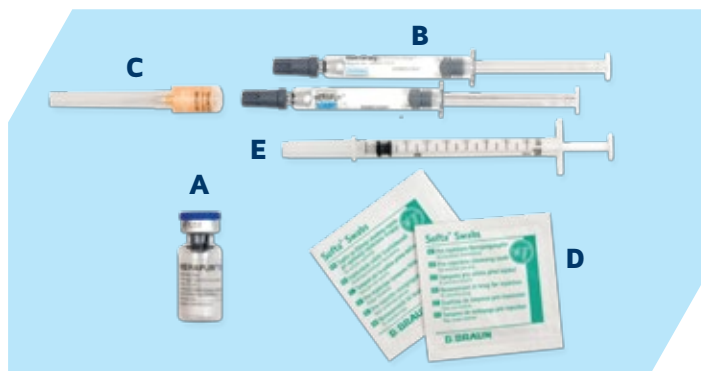

\* Las jeringas para administración están graduadas en unidades FSH/LH.

Se debe tener en cuenta que el vial contiene medicación para varios días de tratamiento.


Se utilizará el contenido de ambas jeringas precargadas para la reconstitución de **Merapur® 1200 UI**.

Sólo extraiga e inyecte la cantidad de medicación indicada.


## Preparación




1. Retire la tapa protectora azul del vial.

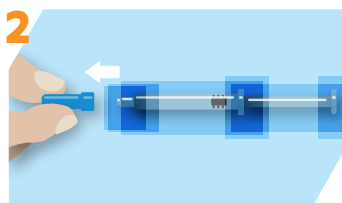


2. Quite la tapa de goma de la jeringa precargada con el disolvente para reconstitución.

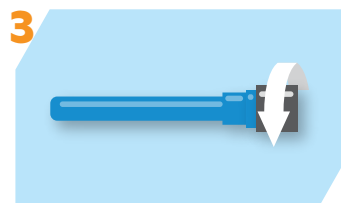

3. Desensrosque el manguito protector negro de la aguja de reconstitución.

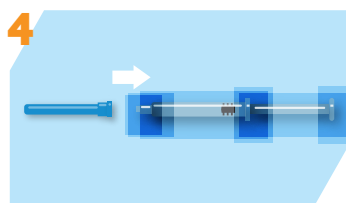


4. Una fuertemente la aguja para reconstitución.

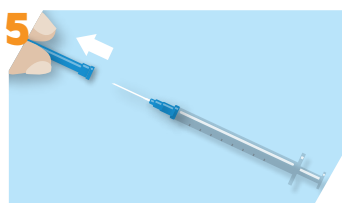

5. A la jeringa precargada y retire la capucha protectora de la aguja.



## Reconstitución

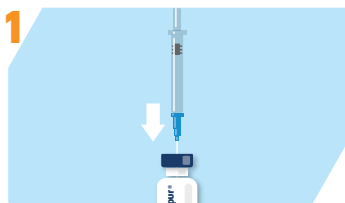

**1.** Inserte cuidadosamente la aguja a través del centro del tapón de goma del vial de **Merapur®** e inyecte lentamente todo el líquido, para evitar la formación de burbujas.

Separe suavemente la jeringa de la aguja con un giro, dejando la aguja en el vial.



**2.** Tome la segunda jeringa precargada retire la cubierta protectora y una firmemente la jeringa a la aguja que está insertada en el vial. A continuación, inyecte todo el líquido en el vial. Hágalo lentamente para evitar la formación de burbujas.


Extraiga la jeringa con la aguja del centro del vial de **Merapur®**.




**3.** Para ayudar a la disolución, mueva suavemente el vial. Evite agitarlo para que no se formen burbujas de aire.

Ahora la formulación está preparada para ser utilizada o para guardarla durante un máximo de 28 días a no más de 25°C.


## Preparación e Inyección

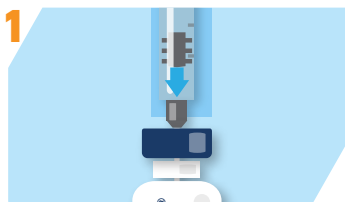


**1.** Tome una jeringa desechable para administración y retire la cubierta protectora de la aguja. Inserte la aguja a través del tapón de goma del vial. Para evitar que se desafilé la aguja, puede utilizar el agujero creado por la aguja de reconstitución en el paso anterior.

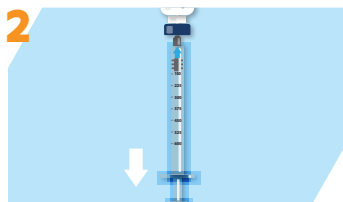

**2.** Ponga el vial boca abajo, como se muestra en el dibujo, y extraiga la cantidad necesaria de líquido del vial tomando como referencia la graduación de la jeringa.

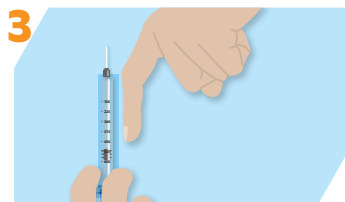


**3.** Golpee suavemente la jeringa hasta que el aire se quede en la parte superior.

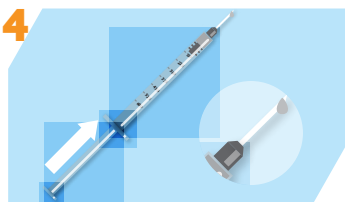

**4.** A continuación, empuje despacio el émbolo hasta que salga todo el aire y aparezca una gota de solución en la punta de la aguja.



**5.** Limpie la zona de inyección con la toallita con alcohol siguiendo las indicaciones que le haya dado su médico o enfermera.

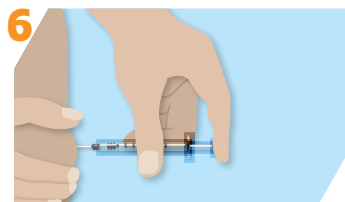

**6.** Pellizque la piel para producir un pliegue. Inserte la aguja con un movimiento rápido a 90° del cuerpo. Empuje suavemente el émbolo hasta el final para inyectar la solución y retire la jeringa.

### IMPORTANTE.

**Antes de la reconstitución:** el envase de **Merapur® 1200 UI** debe conservarse en refrigeración (entre 2°C y 8°C) antes de su uso. No congelar. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz.  
**Después de la reconstitución:** la solución reconstituida en el vial de **Merapur®** puede guardarse durante un máximo de 28 días a no más de 25°C.